

事業廢棄物萃出液中總砷檢測方法

—連續式氫化砷原子吸收光譜法

中華民國 101 年 1 月 6 日環署檢字第 1010002593 號公告
自中華民國 101 年 4 月 15 日生效
NIEA R318.12C

一、方法概要

事業廢棄物萃出液經硝酸/硫酸消化後，使其中之砷先轉變成為五價砷，續以碘化鉀試劑將其還原為三價砷。經由自動化連續流動式氫化物產生裝置，使三價砷與鹽酸及硼氫化鈉試劑進行氫化反應，生成氫化砷，再經由氫氣（或氮氣）載送導入原子吸收光譜儀，於 193.7 nm 波長處測定其吸光度，進行定量。

二、適用範圍

本方法適用於事業廢棄物萃出液中總砷之檢驗，所有樣品均須經適當的消化步驟，方可進行分析，並使用基質樣品添加及適當的參考標準樣品分析，以檢核方法之適用性。

三、干擾

- (一) 高濃度的金屬如鉻、鈷、銅、汞、鉬、鎳及銀等會造成分析上之干擾。
- (二) 樣品經前處理後所留下之微量硝酸會造成分析上的干擾，故樣品在消化過程中必須加熱去除硝酸，直到產生白煙（SO₃）為止。
- (三) 由於元素砷及其化合物均具揮發性，樣品處理應小心進行，以免砷的逸失。

四、設備及材料

- (一) 加熱裝置：可調整溫度之電熱板或加熱消化器。
- (二) 原子吸收光譜儀：需具備有氣體流量計、分光器、光電偵測器、自動化控制及數據處理系統。
- (三) 燈管：砷中空陰極燈管（HCL），或無電極放電式砷燈管（EDL）及其電源供應器。
- (四) 原子化器：不同的儀器廠牌，其規格與形式亦各有異。常見的原子化器有下列幾種，可依適用範圍擇一使用。

1. 電熱式石英管加熱器：以電熱方式加熱石英管至高溫進行原子化。
 2. 火燄式燃燒頭：以氫氣（或氮氣）、空氣與氫氣形成之火燄進行原子化。
 3. 火燄式石英管加熱器：以氫氣與氧氣（空氣）形成之火燄加熱石英管。
- (五) 自動化連續流動式氫化物產生裝置：圖一所示為一般常見之裝置圖，包括有氫化反應系統、氣液分離裝置及樣品注入系統等。將樣品、酸及還原劑以流動注入的方式混合，反應所生成之氫化砷以氫氣（或氮氣）載送，導入原子化器進行分析。
- (六) 排氣裝置：於原子吸收光譜儀之原子化器上方 15 至 30 cm 處裝設抽氣裝置，用以移除源自原子化器產生的煙霧與蒸氣，以保護分析人員免於毒性氣體的危害。
- (七) 分析天平：可精秤至 0.1 mg。

五、試劑

所有檢測時使用的試劑化合物除非另有說明，否則必須是分析試藥級。若須使用其他等級試藥，在使用前必須要確認該試劑的純度足夠高，使檢測結果的準確度不致降低。

- (一) 試劑水：電阻值達 16 M Ω -cm 以上。
- (二) 濃硝酸。
- (三) 濃硫酸。
- (四) 硫酸，9M：在 100 mL 量瓶內先加入部份試劑水，再慢慢加入 50 mL 濃硫酸，並以試劑水定容到 100 mL。
- (五) 濃鹽酸。
- (六) 鹽酸，10 %(v/v)：取適量試劑水加入 10 mL 濃鹽酸，最後以試劑水定容至 100 mL。
- (七) 稀釋液：在 1000 mL 量瓶內先加入 400 mL 試劑水，再加入 100 mL 9M 硫酸及 400 mL 濃鹽酸，並以試劑水定容到 1000 mL。
- (八) 碘化鉀（或碘化鈉）溶液：於 100 mL 試劑水中溶解 20 g 碘化鉀（或碘化鈉）。
- (九) 硼氫化鈉 / 氫氧化鈉溶液：取 5 g 硼氫化鈉及 10 g 氫氧化鈉以試

劑水定容至 1000 mL，使用前配製。

- (十) 砷儲備溶液，1,000 mg/L：購買經濃度確認之標準品，或在 1000 mL 量瓶內，於含有 4 g 氫氧化鈉之 100 mL 試劑水中溶解 1.320 g 三氧化二砷（註 1），再以 20 mL 之濃硝酸酸化後，以試劑水定容至刻度。
- (十一) 砷中間溶液：精取 1.00 mL 砷儲備溶液，置於 100 mL 量瓶內，以每升含 1.5 mL 濃硝酸之稀硝酸溶液定容至刻度；1.00 mL = 10.0 $\mu\text{g As}$ 。
- (十二) 砷標準溶液：精取 10 mL 砷中間溶液，置於 100 mL 量瓶內，以每升含 1.5 mL 濃硝酸之稀硝酸溶液定容至刻度；1.00 mL = 1.00 $\mu\text{g As}$ 。

六、採樣及保存

樣品已經「事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）」所得之萃出液應儘速分析，否則應以 HNO_3 酸化至 $\text{pH} < 2$ ，貯存於 $4 \pm 2^\circ\text{C}$ 最長可保存 6 個月；惟若萃出液酸化時會產生沉澱，則應取未經酸化萃出液儘速分析。

七、步驟

- (一) 取 50 mL 事業廢棄物萃出液或待消化的樣品，置於燒杯中，加入 10 mL 濃硝酸及 12 mL 9M 硫酸，在煙櫥中以電熱板加熱消化，直到產生白色 SO_3 煙霧。勿使樣品燒焦或變黑，以免逸失砷。若發生燒焦現象應立即關掉加熱裝置、冷卻之並另外加入 3 mL 濃硝酸。為避免在消化過程中逸失砷，不可讓溶液顏色變深，每當二氧化氮紅棕色煙霧消失時，停止加熱並冷卻後，再加入 3 mL 之濃硝酸繼續消化，直至三氧化硫白煙發生，且水樣呈無色或淡黃色時表示已消化完全，停止加熱。
- (二) 冷卻樣品，加入約 25 mL 水，加熱至三氧化硫白煙發生，以除去氮氧化物。
- (三) 冷卻樣品，將此消化液移入 50 mL 量瓶中，加入 20 mL 濃鹽酸，以試劑水定量至刻度。
- (四) 檢量線配製：配製一個空白和至少五種不同濃度的檢量線標準溶液，其濃度範圍如 0 至 25 $\mu\text{g/L}$ ，或其他適當濃度範圍之砷標準溶液，分別置於 100 mL 量瓶中，以稀釋液定容至刻度。
- (五) 樣品分析：如下所述，或依據儀器操作使用說明操作。（註 2）

- 1、取消化後的樣品或標準溶液 25 mL，置於反應瓶。
- 2、加入 1.0 mL 碘化鉀（或碘化鈉）溶液，以去離子水稀釋定量至 50 mL。靜置一小時後，待五價砷還原成三價砷即可進行分析。
- 3、以取樣管（或自動取樣器）導入樣品注入迴路中（迴路體積一般為 1 mL），如圖一 A 所示。
- 4、按圖一 B 所示方式，改變流動注入閥至注入位置。藉由幫浦的推動，分別將 10.0 (v/v) % 鹽酸、硼氫化鈉 / 氫氧化鈉溶液與 1.0 mL 樣品，經由不同管路，以連續流動的方式，注入氫化反應槽（圖一 C）中混合，反應生成氫化砷。
- 5、生成之氫化砷及其他的氣液混合產物在氫氣（或氮氣）帶動下，隨即進入氣液分離器（圖一 D）中進行分離。氫化砷在氫氣（或氮氣）載送下瞬時被導入原子化器（圖一 E）中原子化，並於波長 193.7 nm 處被測定。
- 6、由檢量線求出樣品中的砷濃度

八、結果處理

$$\text{事業廢棄物萃出液中總砷濃度}(mg/L) = \frac{A \times V_2}{V_1 \times 1000}$$

其中：A=檢量線求得砷含量（ $\mu\text{g/L}$ ）

V_1 =消化液取樣體積（mL）

V_2 =上機前最終定量體積（mL）

九、品質管制

一般品質管制請參見「重金屬檢測方法總則（NIEA M103）」、「事業廢棄物檢測方法總則（NIEA R101）」及「事業廢棄物毒性特性溶出程序（NIEA R201）」的規定。

- （一）檢量線：每次樣品分析前應重新製作檢量線，其線性相關係數（r 值）應大於或等於 0.995。檢量線製作完成應即以第二來源標準品配製接近檢量線中點濃度之標準品確認，其相對誤差值應在 $\pm 20\%$ 以內。

- (二) 檢量線查核：每 10 個樣品及每批次分析結束時，執行一次檢量線查核，以檢量線中間濃度附近的標準溶液進行，其相對誤差值應在 $\pm 20\%$ 以內。
- (三) 空白樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次空白樣品分析，空白分析值應小於二倍方法偵測極限。
- (四) 重複樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次重複樣品分析，其相對差異百分比應在 20% 以內。
- (五) 查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次查核樣品分析其回收率應在 $80\sim 120\%$ 範圍內。
- (六) 添加樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行一次添加樣品分析，其回收率應在 $75\sim 125\%$ 範圍內。

十、精密度及準確度

本方法經國內某單一實驗室針對事業廢棄物萃出液真實基質樣品進行九次分析，其添加回收率 $95\sim 102\%$ ，相對標準偏差為 2.01% 。

十一、參考資料

- (一) USEPA, Test Methods for Evaluating Solid Wastes Physical / Chemical Methods, SW-846, Arsenic (Atomic Absorption Spectrophotometry Gaseous Hydride), Method 7061A, 1992.
- (二) USEPA, Test Methods for Evaluating Solid Wastes Physical / Chemical Methods, SW-846, Flame Atomic Absorption, Method 7000B, 2007.
- (三) 行政院環境保護署，重金屬檢測方法總則(NIEA M103.01C)，2002。
- (四) 行政院環境保護署，事業廢棄物檢測方法總則 (NIEA R101.01C)，1999。
- (五) 行政院環境保護署，事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201.12C)，2002。

註 1：三氧化二砷， As_2O_3 為固體具有劇毒應避免食入。

註 2： As_2O_3 (固體)、 AsH_3 (氣體) 均為毒性極強之血液性毒劑，請操作者

應極小心避免食入及吸入。

註 3：本檢測方法產生之廢液，依一般重金屬廢液處理原則處理。


註 4：本文引用的公告方法名稱及編碼以環保署最新公告者為準。

註 5：建議所使用之原子吸收光譜儀應含有背景校正裝置。

表一 廢棄物毒性特性溶出程序萃出液真實基質樣品添加 (10 µg/L) 之精密
度及準確度測試結果

測值 µg/L	平均測值 µg/L	平均回收率 (%)	標準偏差 µg/L	相對標準偏差 (RSD)%	準確度 (X)%
9.84	9.87	98.7	0.198	2.01	96.7-100.6
9.91					
9.81					
9.90					
10.20					
9.78					
9.76					
10.09					
9.51					

資料來源：行政環境保護署環境檢驗所

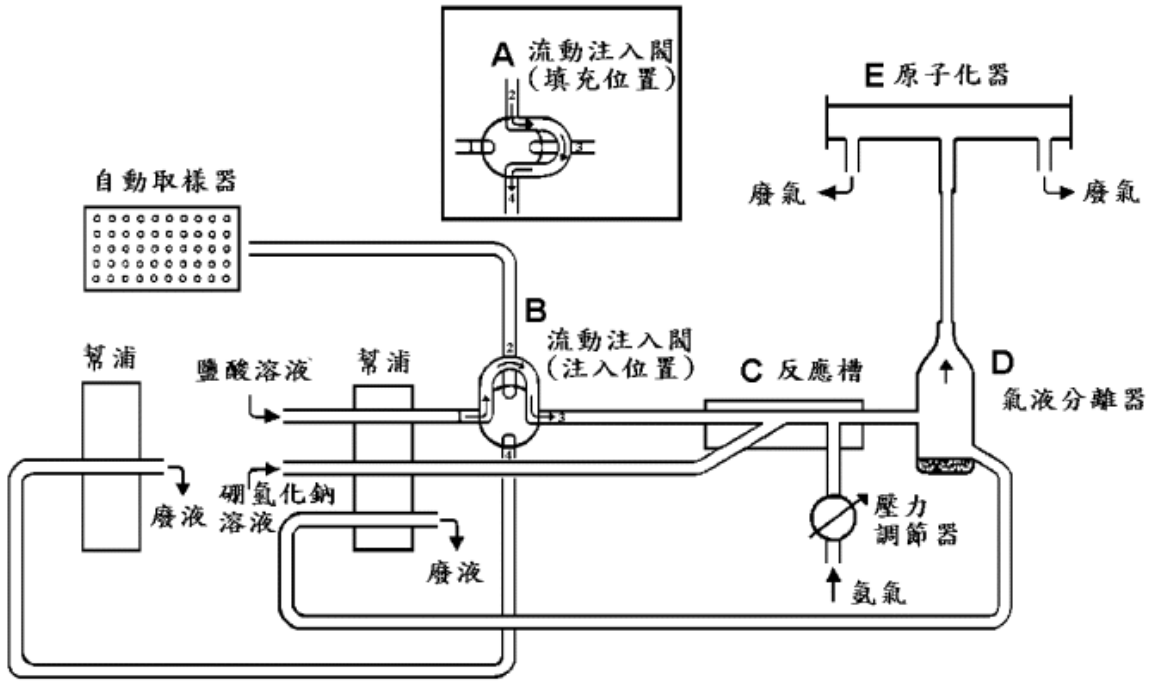

圖一 自動化連續流動式氫化物產生裝置連接原子吸收光譜儀之系統圖例